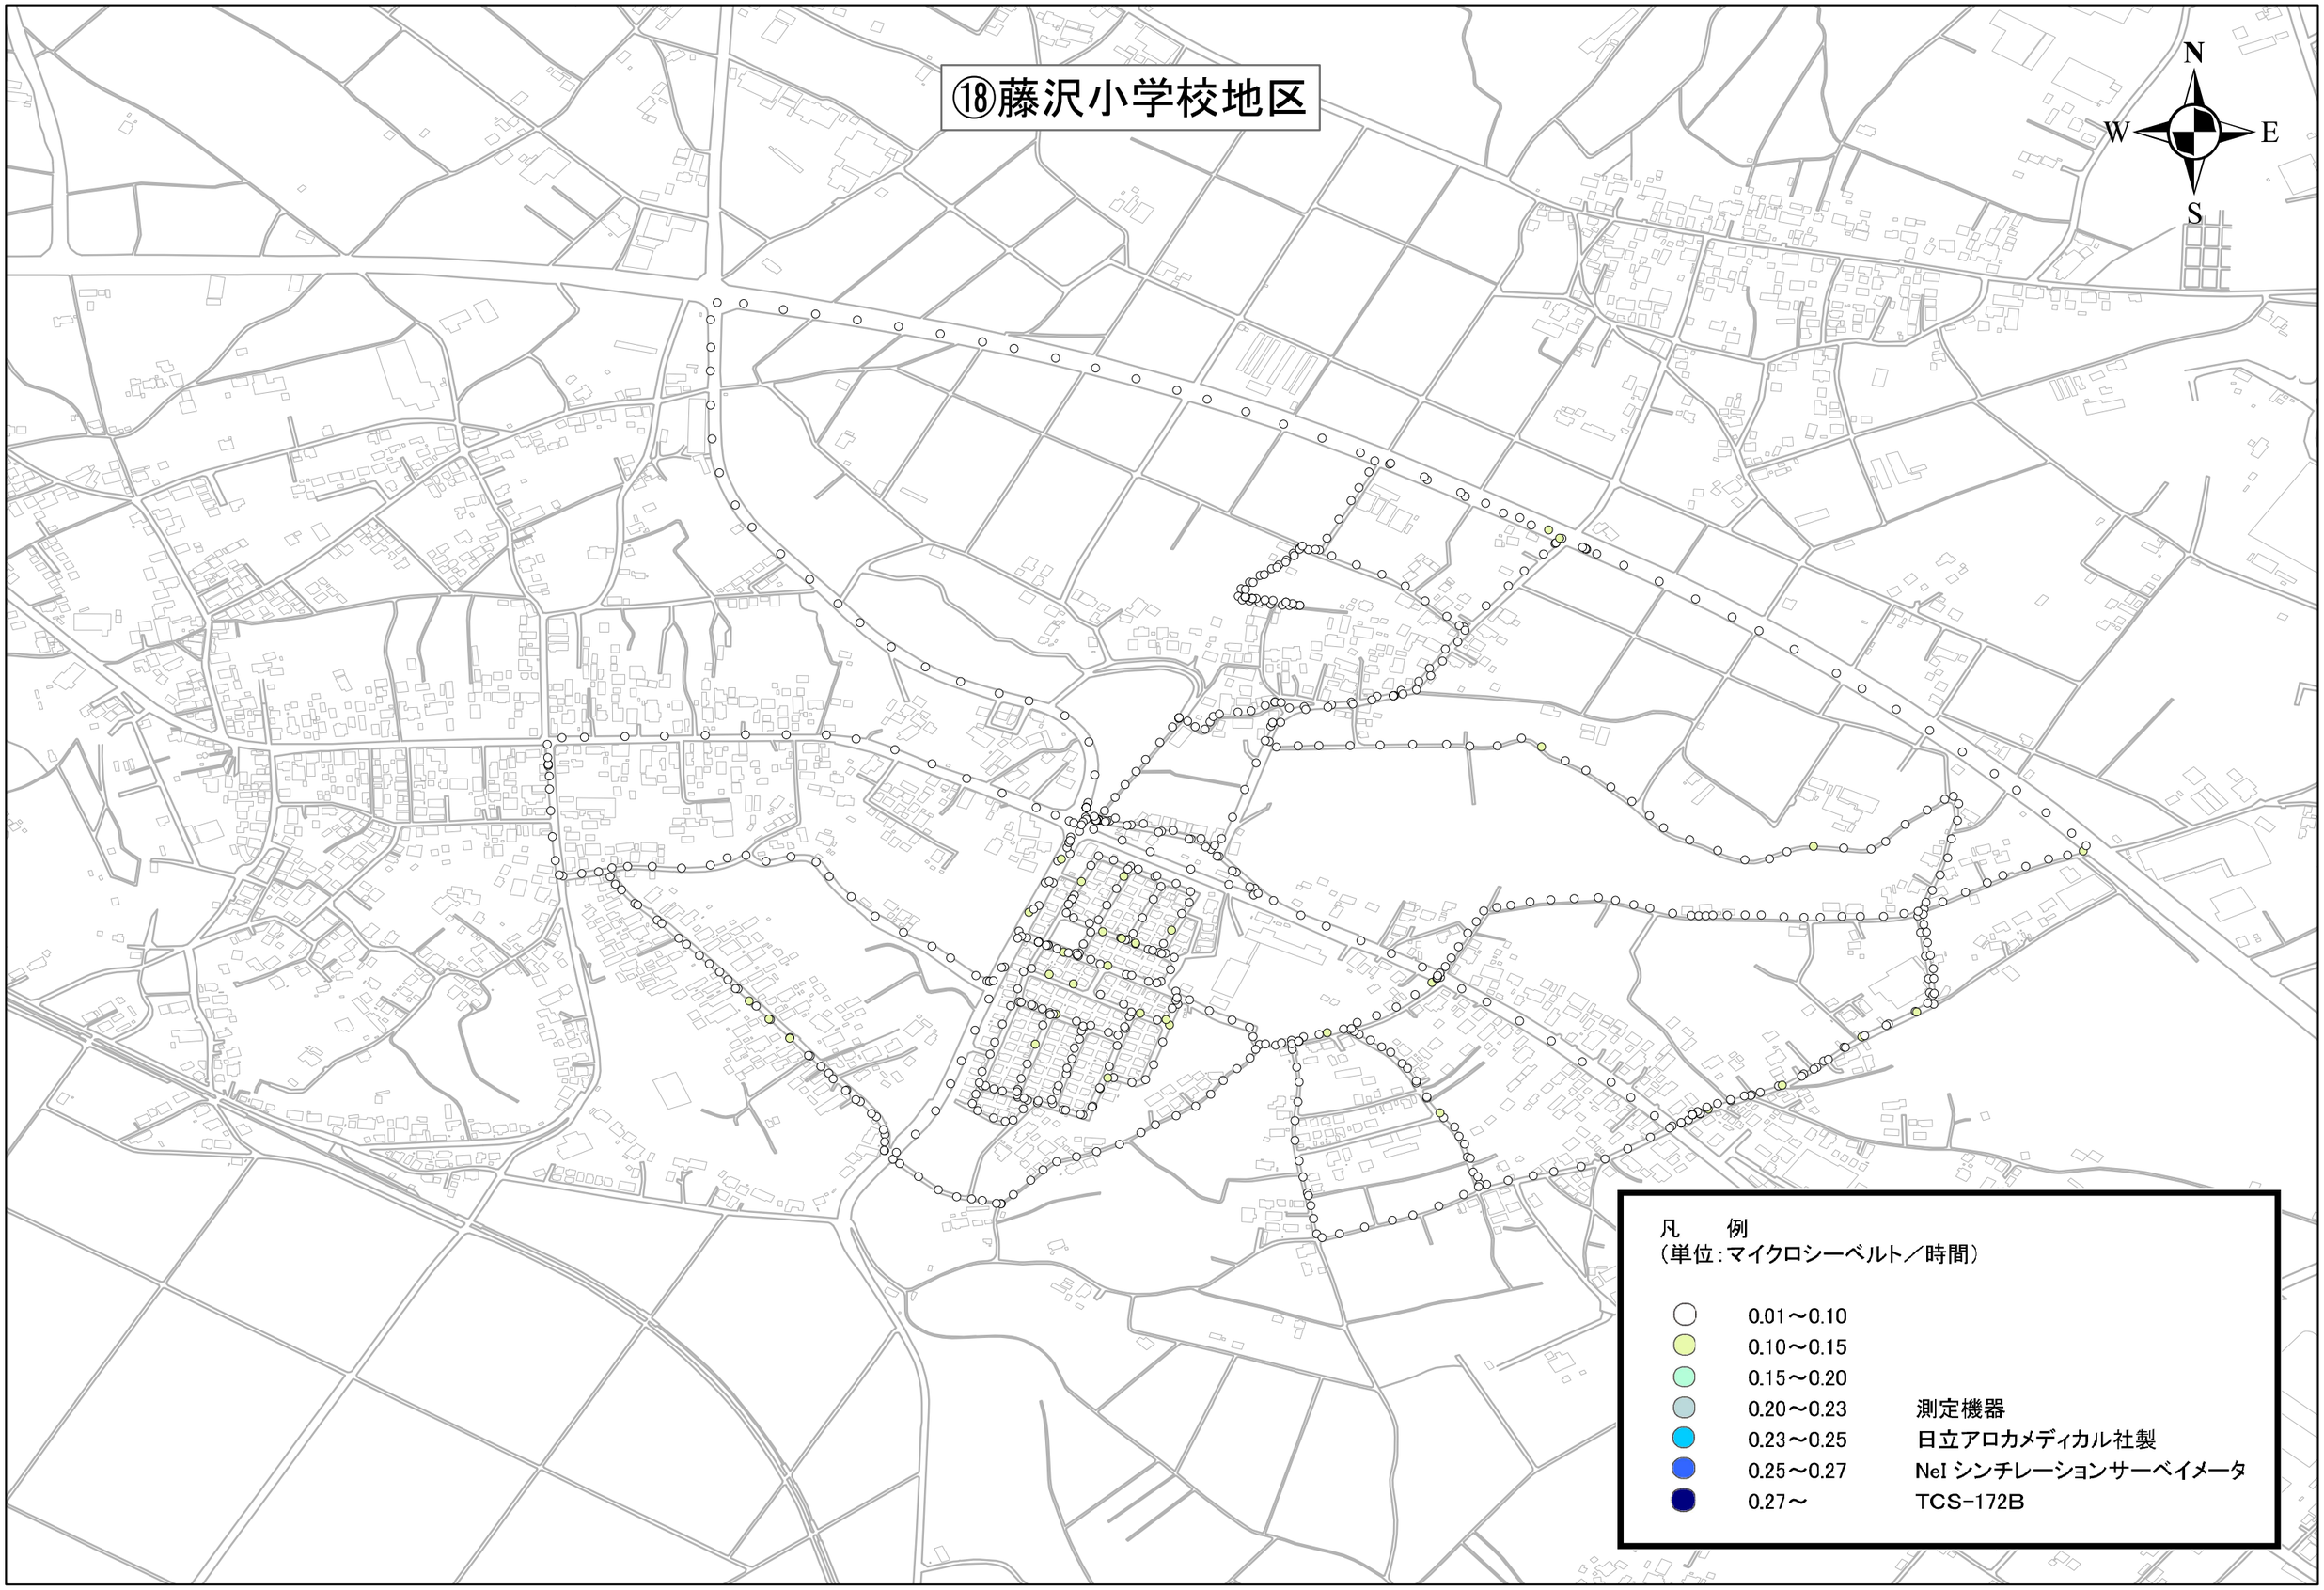
⑱藤沢小学校地区
N
W
E
S
凡　例
（単位：マイクロシーベルト／時間）
0.01～0.10
0.10～0.15
0.15～0.20
0.20～0.23
0.23～0.25
0.25～0.27
0.27～
測定機器
日立アロカメディカル社製
NeI シンチレーションサーベイメータ
TCS-172B